



在宅難病患者遠隔医療支援サイト


えんぽーと

災害時個別支援計画書の共有 レスピ情報共有について

認定NPO法人アンビシャス
沖縄県難病相談支援センター
センター長 照喜名 通

なぜ必要か？No.1

レスパイト入院などで人工呼吸器の乗せ換え時
診療情報提供書の中にレスピ設定内容の
記載が無く、乗せ換えが出来ない




探して、確認に時間がかかる(夕方)

なぜ必要か？No.2

モニターへの故障

機器のモニターが故障し、設定内容が把握できない



結果を表示閲覧可能な内容

画像ファイル

PDFファイル

テキスト

2016年10月21日 09:45:33 現在

患者名 [患者 太郎]

題名 [VELIA画像]



2016年05月13日 09:43:43 現在

患者名 [患者 太郎]

題名 [入力確認 ME]

沖縄病院 ME 運用モデル 構築

2016年02月29日 12:30:14 現在

在宅人工呼吸療法指導書 クリーンエアVELIA

患者氏名	患者 太郎
生年月日	1980-01-01
性別	男
年齢	36歳
病歴	慢性気管支炎
アレルギー	アレルギー性鼻炎
喫煙	喫煙者
飲酒	飲酒者
手術歴	なし
現在病状	慢性気管支炎発作
治療方針	吸入療法
薬剤	吸入ステロイド薬
酸素療法	必要に応じて
人工呼吸器	必要に応じて

★H28年 3月22日 現在 実測PIP: 28mmHg SPO2: 96%
(この情報は訪問看護の方が更新して頂けたら助かります)

※人工呼吸器の設定値はPDFで必ず確認してください。

人工呼吸器の作動可能時間 約5時間(満充電時)
外部O₂ ガス(約5時間) 1台を在宅で使用

2016年02月29日 12:30:14 現在

→機器の不具合・消耗品の相談

→指導病院 : 沖縄病院 : 098-898-2121

→診療についての相談

モード VC-SIMV
換気量 500ml 7L
回数 20回 高圧: 40cm 低圧: 8cm
PEEP 5mmHg 呼吸回数上限: 40回
FIO2 23%

★H28年 3月22日 現在 実測PIP: 28mmHg SPO2: 96%
(この情報は訪問看護の方が更新して頂けたら助かります)


※人工呼吸器の設定値はPDFで必ず確認してください。

人工呼吸器の作動可能時間 約5時間(満充電時)
外部O₂ ガス(約5時間) 1台を在宅で使用

内容の閲覧手順



カメラをQRコードに向ける

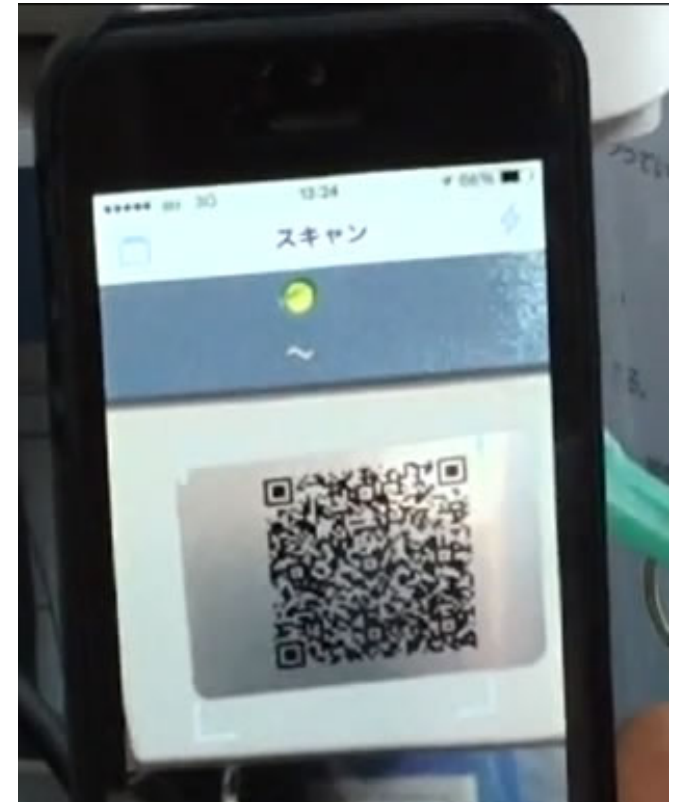

QRコードをスキャン(撮影)

メリット・デメリット

メリット

緊急時に閲覧できる

関係者がデータで管理共有できる

デメリット

ネット環境が無いと閲覧出来ない

入力手間(データ保存)が面倒

複数管理が重要

- ★紙で残しても、失くす、流された、燃えた
防水、防火、冷蔵庫に入れる
- ★データ(PC)で残しても、停電、故障など
USB,DVD,HDDバックアップ、発電機など
- ★ネットでも残しても、インターネットダウン
有線(光)、無線(モバイル)、複数キャリア

参加募集のご案内

1. 関係機関として登録する場合

アンビシャスへ登録申込を提出し可能となります

2. 患者さんが参加する場合

アンビシャスへ情報共有同意書が必要です。

QRコードサンプルを
お試しください



申込・問合せ：認定NPO法人アンビシャス

TEL.098-951-0567

E-mail info@ambitious.or.jp 担当：照喜名 通